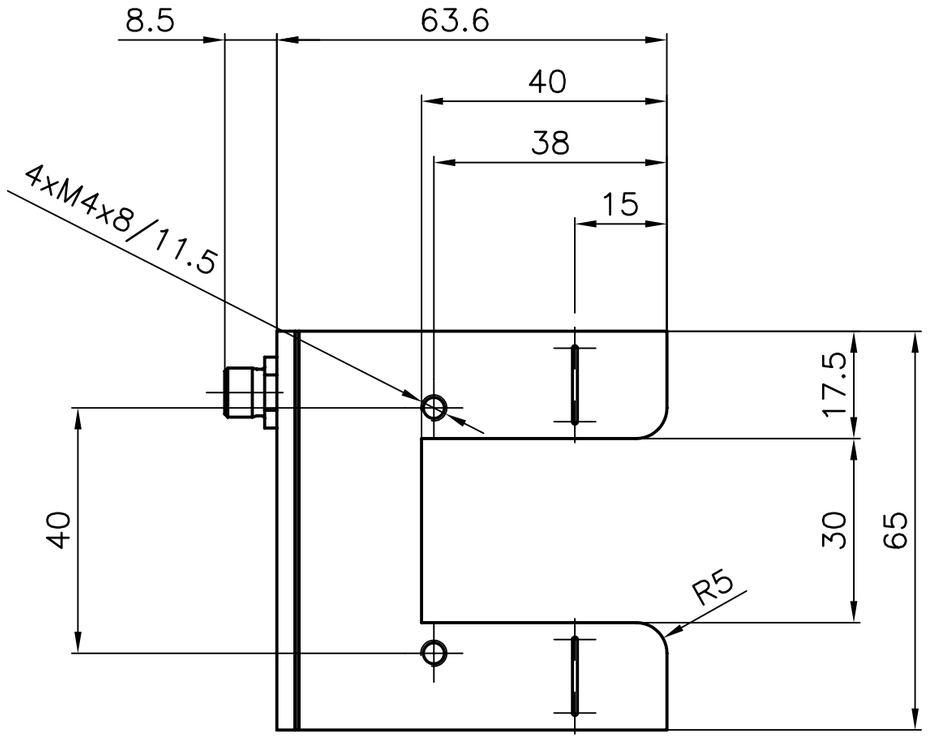

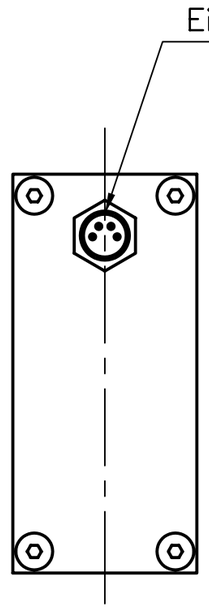

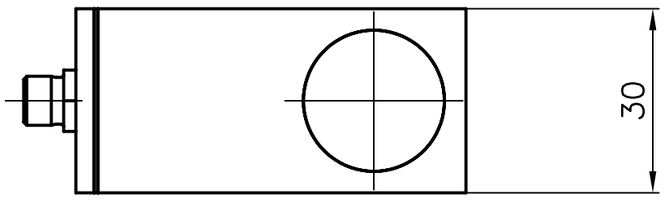

Zul. Abweichungen in mm nach SN258440 bzw. DIN7168 mittel	Nennmassbereich					
	>0.5–3	>3–6	>6–30	>30–120	>120–400	>400–1000
Laengenmasse	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
Radien/Fasen	±0.2	±0.5	±1	±2	±4	

Passmass | Abmass in µm

				1	Ultraschall Sensor	1					
Stueckzahl				Gegenstand		Pos.	Werkstoff	Gewicht	Modell/Rohteil		Bemerkungen
IV	III	II	I	US01B Utraschall Sensor				Massstab 1:1 bei DIN A3	Ersetzt durch: Ersatz fuer: Entstanden aus:		
										Datum	Name
									Gezeichnet	23.06.08	Sum
								Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	Geprueft		
									Gesehen		

FMS Force Measuring Systems AG
Aspstrasse 6
CH–8154 Oberglatt
Tel. +41 44 852 80 80
Fax +41 44 850 60 06
info@fms–technology.com
www.fms–technology.com

D3–031020.1 b